


VASTAGBÉL-TÜKRÖZÉS

A vastagbél

A vastagbél az emésztőrendszer utolsó szakaszát jelenti, benne történik a béltartalom maradék víztartalmának visszaszívása, és kialakul a széklet.

A vastagbél kb. 1,5 m hosszúságú és 5-7 cm vastag.

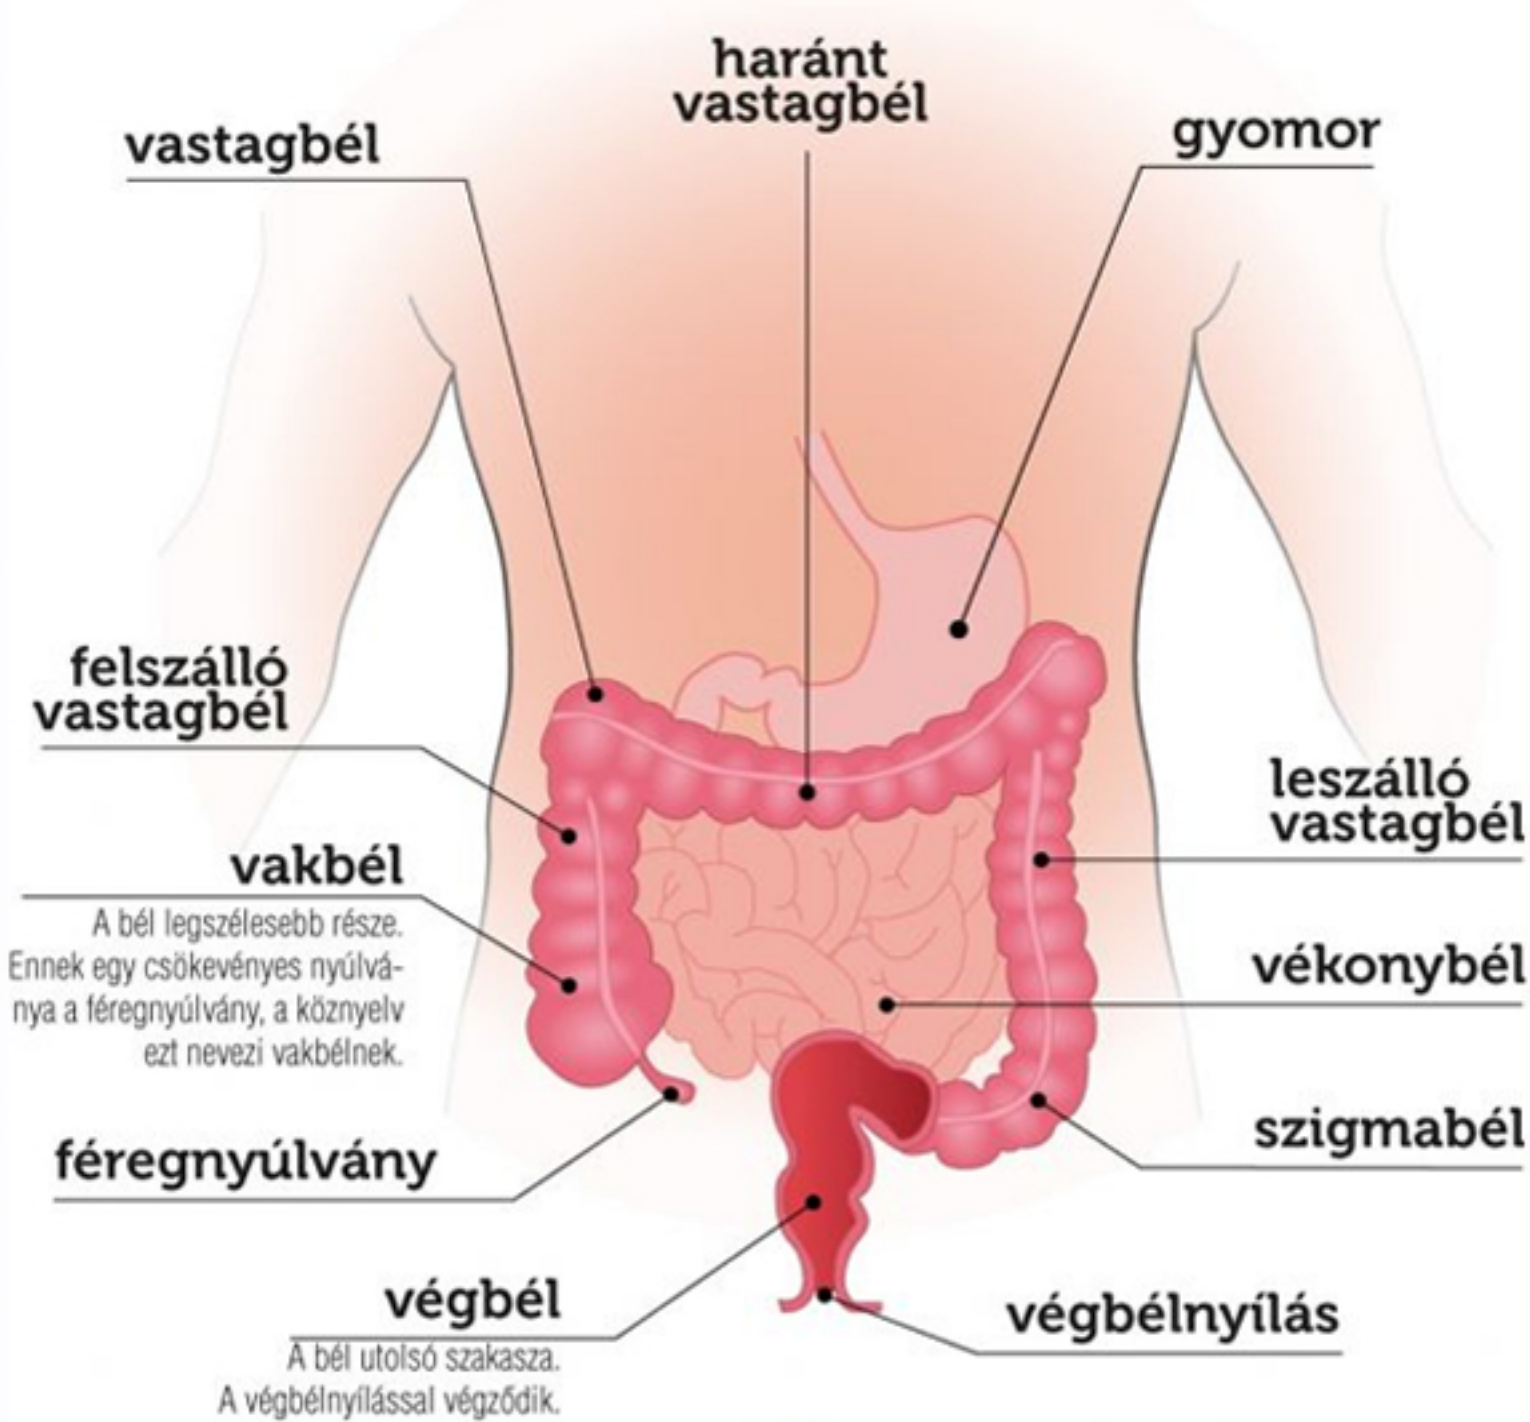


Béltükrözés (kolonoszkópia, colonoscopia) szükséges:

- › nehezen karakterizálható, hastáji fájdalom esetén,
- › túlzott, fájdalmas teltségérzés esetén,
- › véres széklet jelentkezésekor,
- › végbél vérzése esetén,
- › hasmenés, székrekedés esetén,
- › székelési szokások megváltozásakor,
- › a vastagbél nyálkahártyájának áttekintésére.

Vizsgálat

A video-endoszkóp 130-150 cm hosszú, hajlékony, irányítható véggel rendelkező eszköz, a végén lévő mini-videokamera jele a monitoron látható. A világítást nagy fényerejű hideg fényforrás biztosítja. Lehetőség van víz, illetve levegő bejuttatására is. A vezérlőhöz különböző eszközök csatlakoztathatók, mintavételre és kisebb beavatkozások elvégzésére is alkalmas.

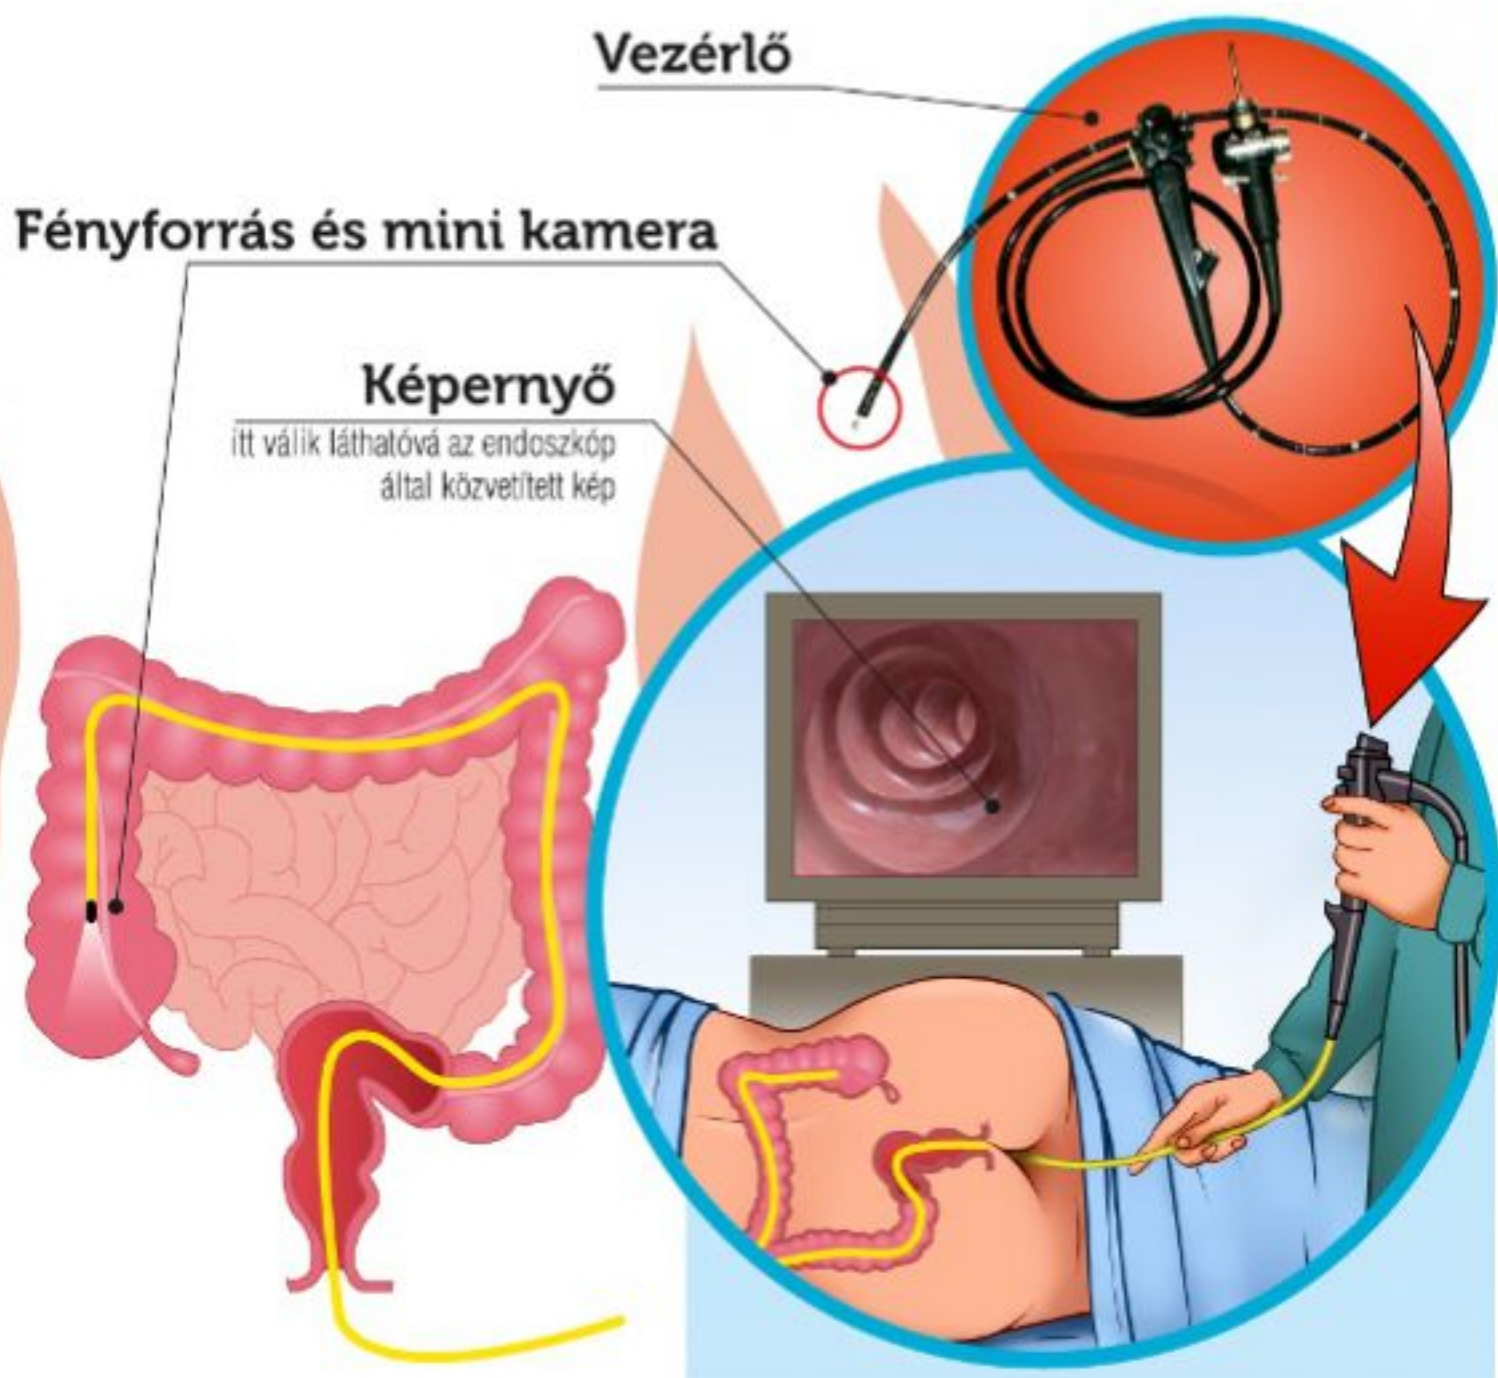

ELŐKÉSZÜLET:

- › 3-4 napos étrendi előkészítés,
- › ritka esetekben beöntés is szükséges lehet,
- › a vizsgálatot általában bódításban végzik.

A vastagbéltükrözés szükséges:

- › daganatok felismeréséhez,
- › gyulladás megállapításához,
- › polipok felfedezéséhez,
- › mintavételhez.

A VIZSGÁLAT FOLYAMATA:

Fontos, hogy a vizsgált személy ne mozogjon és nyugodtan lélegezzon.

- › a páciens a bal oldalára fekszik felhúzott lábakkal (orvosi utasításra hasára, hátára és hasára is fordulhat),
- › az eszközt csúszássegítő zselével kenik be, így vezetik a végbélbe,
- › a könnyebb előrejutás érdekében levegőt és vizet juttatnak be,
- › a vizsgálat célja, hogy a vastagbelet a vakbél (vastagbél-vékonybél találkozásig) átvizsgálják).

Időtartam: 10-40 perc.



A vizsgálat alatt az eszköz által provokált **székelési ingert**, a befújt levegő miatt **haspuffadást, hasi görcsöket, hasi fájdalmat** érezhet a páciens.

A gyógyszeres előkészítés **szédülést, hányingert, hányást, csuklást** okozhat.



Orvosoktól betegeknél, hitelesen.
www.webbeteg.hu